

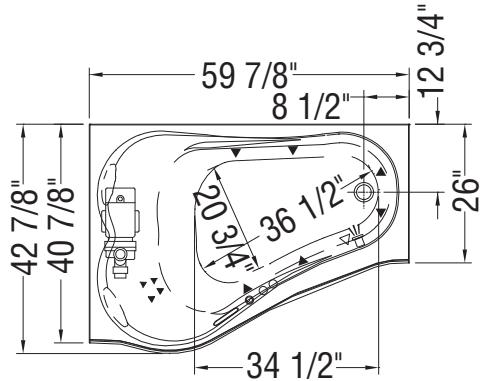


## SYSTÈME MICRO-JETS

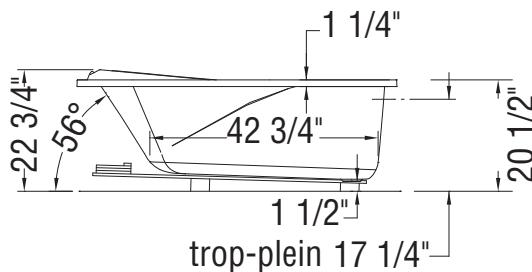

## SYSTÈMES HYDROSENS, BACKMAX ET À AIR

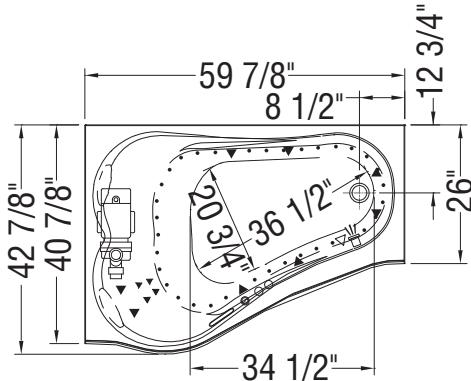

- ( ▲ ): Indique la position des jets tourbillon et dorsaux
- ( △ ): Indique la position de succion
- ( • ): Indique la position des jets d'air
- ( ▨ ): Indique la position de la chromothérapie

Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.